


# INSTRUKCJA MONTAŻU

# NEXXT

Emerson Polska Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Tryb.  
www.nexxt.com.pl

**DOZOWNIKI:** NHS11DPW, NHS11DPB, NHS11DPG, NHS11DPS

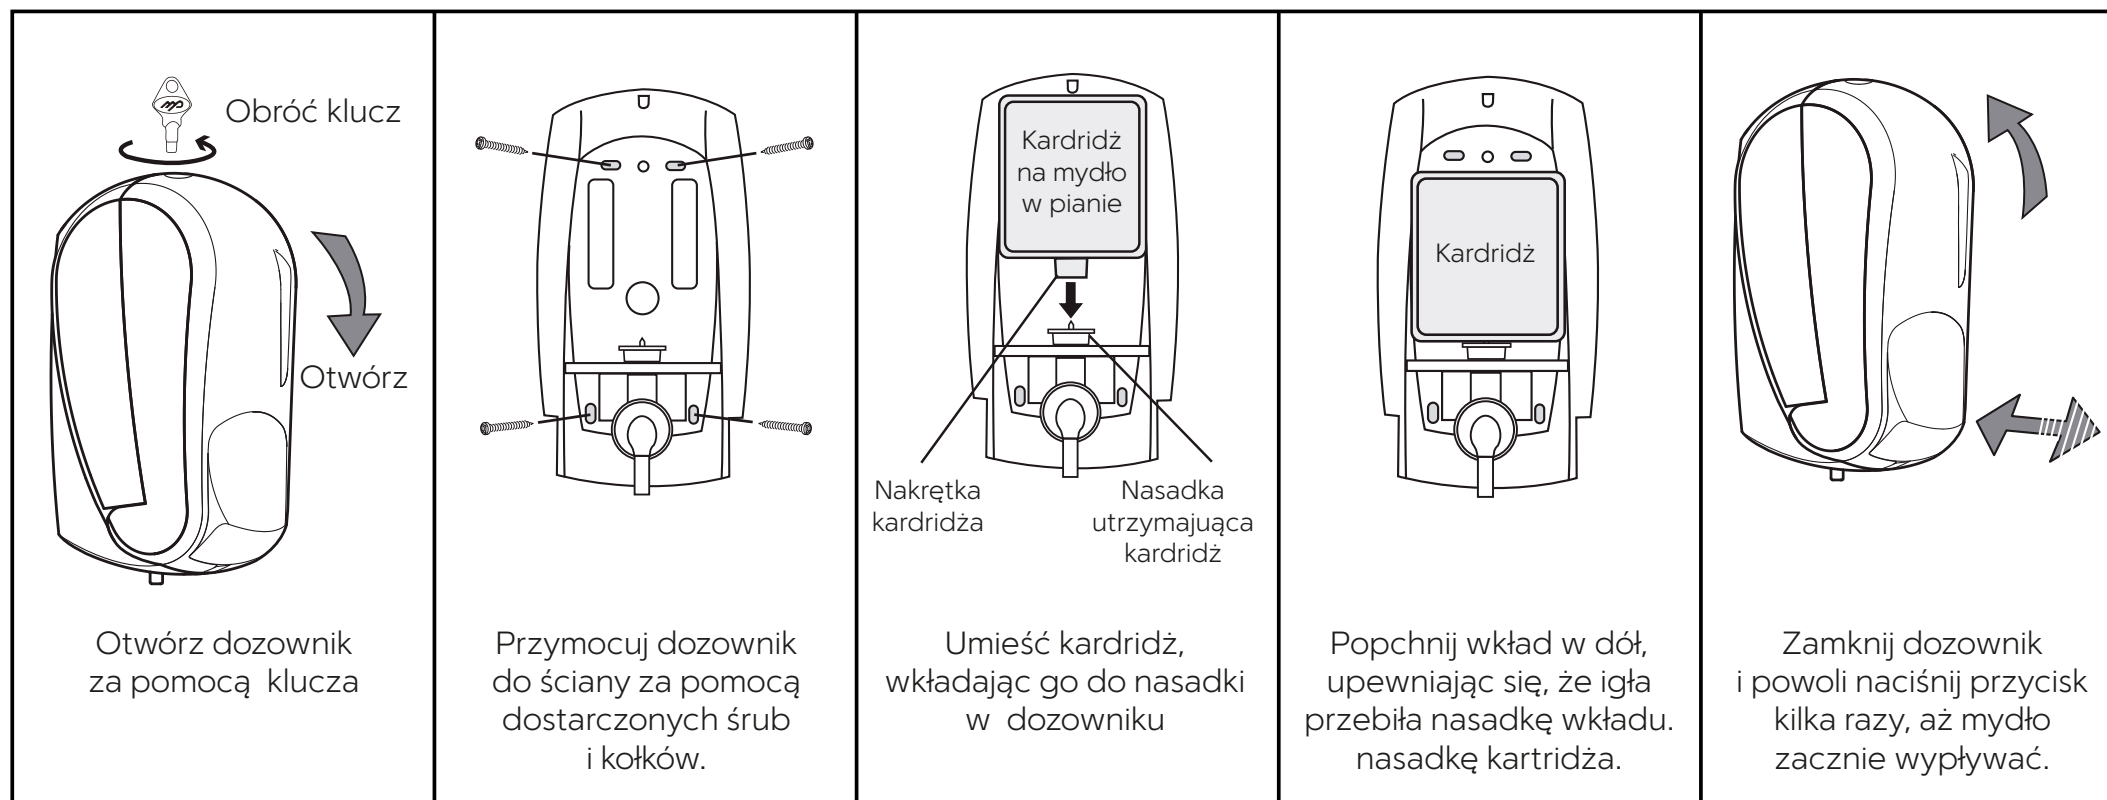

**Zaleca się regularne czyszczenie dozownika w celu zapewnienia optymalnej higieny.** Do usuwania kurzu zaleca się używanie miękkiej, wilgotnej ściereczki. W razie potrzeby użyj niewielkiej ilości rozcieńzonego neutralnego detergentu i przetrzyj kilka razy miękką wilgotną szmatką, aż detergent zostanie całkowicie usunięty.